


样品信息

| | | | |
|-------|------------------------|---------|-----------------|
| 样品名称: | TPM | 采集者: | System |
| 样品类型: | 标准样 | 样品组名称: | 20230712 |
| 样品瓶: | 1:A,2 | 采集方法组: | TPM |
| 进样次数: | 1 | 处理方法: | 1 |
| 进样体积: | 10.00 ul | 通道名称: | W2489 ChA |
| 运行时间: | 20.0 Minutes | 处理通道说明: | W2489 ChA 274nm |
| 采集时间: | 2023/7/12 22:36:02 CST | | |
| 处理时间: | 2024/6/19 18:23:57 CST | | |

自动缩放色谱图

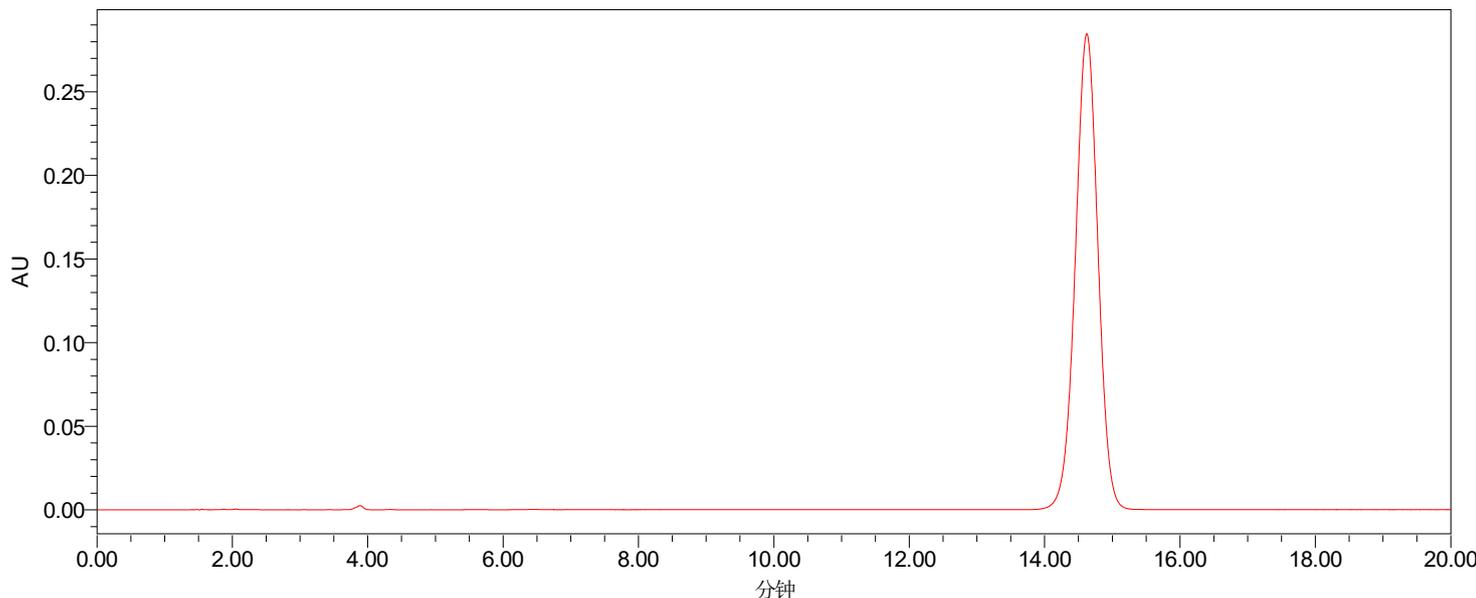

峰结果

| 名称 | 保留时间 (分钟) | 面积 (微伏*秒) | 高度 (微伏) | % 面积 | USP 分离度 | 对称因子 | 分离度 |
|----|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2.049 | 1251 | 367 | 0.02 | | 1.087260e+00 | |
| 2 | 3.889 | 72667 | 2445 | 1.10 | 1.120073e+01 | 8.910923e-01 | 1.241460e+01 |
| 3 | 14.623 | 6532160 | 284617 | 98.88 | 2.511858e+01 | 9.894929e-01 | 2.657807e+01 |